



РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

i-Port Advance™

Установка



Вымойте руки с мылом




Протрите место установки спиртовой салфеткой и дождитесь, пока поверхность высохнет



Потяните за красную ленточку и удалите пластиковую упаковку



Удалите стерильную защитную бумагу




Снимите пластиковую крышку с устройства




Удалите защитную стерильную бумагу с пластиря



Откручивающими движениями удалите защитный пластиковый колпачок с иглы




Расположите устройство по направлению иглой вниз



Держите устройство за места, отмеченные линиями с двух сторон устройства, потяните за центральную часть устройства для введения до тех пор, пока не услышите щелчок




Приложите устройство для введения к подготовленному месту для установки и расположите пальцы на круглые выемки с двух сторон устройства. Нажмите одновременно на круглые выемки, чтобы ввести инъекционный порт



Надавите на центральную часть устройства для введения для надежного крепления ай-порт адванс на коже



Удалите устройство для введения, удерживая его за центральную часть



Придавите пластырь для более надежного крепления инъекционного порта на коже



Наденьте пластиковую крышку на устройство для введения и утилизируйте его в соответствии с нормами утилизации острых предметов

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ:


- Перед тем, как установить i-Port Advance™, уточните разницу между "круглыми выемками" и "местами, отмеченными линиями" устройства i-Port Advance™
- Чтобы удалить инъекционный порт, держите только за центральную часть устройства для введения (см. Шаг 11)

Medtronic
Further, Together


РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

i-Port Advance™


Использование




Протирайте
инъекционный порт
чистой водой перед
каждым использованием



Ведите иглу шприца
в инъекционный порт




Медленно введите
препарат



Удалите иглу из порта

Удаление




Потяните за край
пластыря и удалите его

Из чего состоит i-Port Advance™



Куда устанавливать?

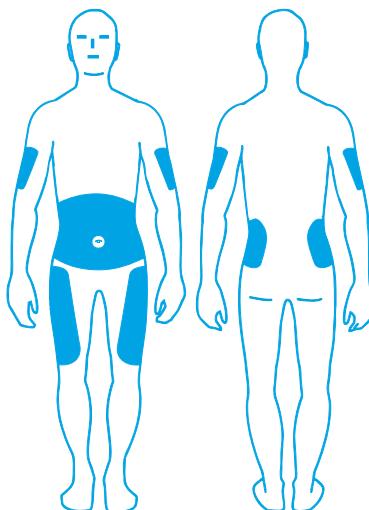

■ Места для установки

Данная брошюра содержит дополнительную информацию к руководству пользователя.
Пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя для получения полной информации об устройстве.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

- Используйте i-Port Advance™ со шприцами и шприц-ручками с иглой длиной от 5 до 8 мм и диаметром не более 0,4 мм.
- Один инъекционный порт может использоваться как для инсулина длительного действия, так и для инсулина короткого действия, при условии, что между инъекциями соблюдается промежуток времени в 60 минут, и что сначала вводится инсулин короткого действия.
- После 72 часов использования инъекционного порта или 75 инъекций (что наступит ранее), необходимо сменить устройство и место установки.

Для ознакомления с показаниями, противопоказаниями, а также другой важной информацией, пожалуйста,
обратитесь к руководству пользователя.

Medtronic

Россия:

ООО "Медтроник"
123112, Москва,
Пресненская набережная, 10,
Башня на Набережной
Тел.: (495) 580 73 77
24/7 линия поддержки:
8 800 200 76 36

www.medtronic-diabetes.ru

Производство компании Unomedical